

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.
LABORATORIO DE METROLOGÍA
CARTA DE TRAZABILIDAD
“TEMPERATURA”
ACREDITACIÓN: T-62
MR-CT-5.6-19.9

MÉTODO DE COMPARACIÓN INTERNA
 MT-CT-5.4-T-11




PUNTOS FIJOS
 420AC-P.029
 CENAM

CENAM
 PUNTOS FIJOS DE LA ESCALA INTERNACIONAL DE
 TEMPERATURA 1990 (EIT-90)

METAS
 TERMÓMETRO SPRT
 MARCA/ MODELO: pt 25,5 Ω
 CLAVE ID: MA-RTD33/13;MA-RTD36/14;MA-TCS05/03;
 CERTIFICADO: CNM-CC-420-057/CNM-CC-420-058; CNM-CC-420-115/2014
 CNM-CC-420-075/2016; CNM-CC-420-076/2016
 INCERTIDUMBRE: (±0,011 °C ...±1,9 °C)
 K=2

TRAZABILIDAD EXTERNA

TRAZABILIDAD INTERNA

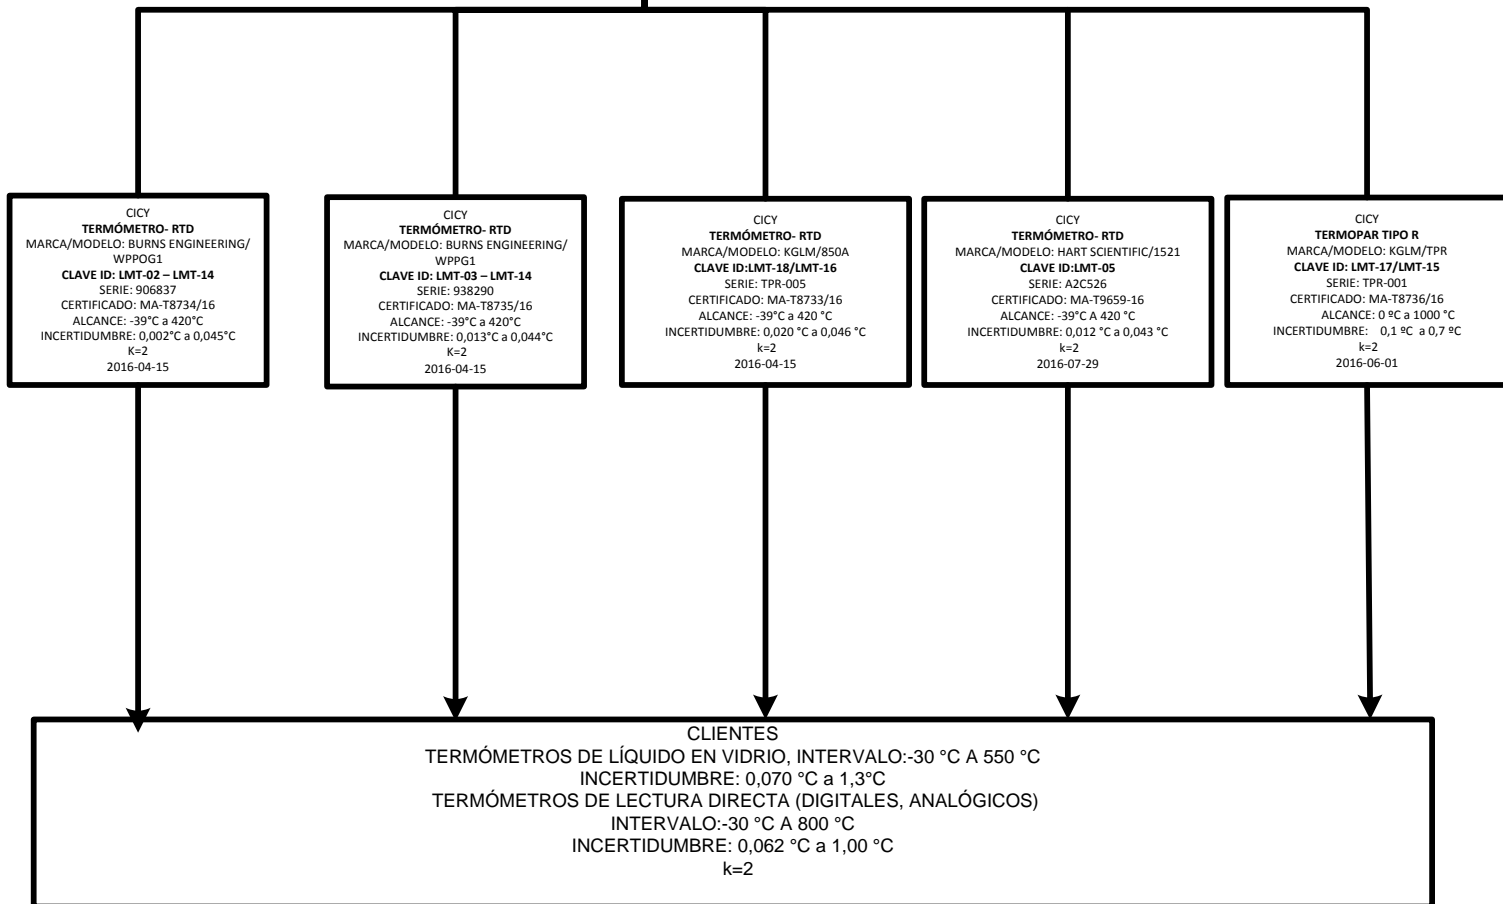

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2016