




CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.
LABORATORIO DE METROLOGÍA
CARTA DE TRAZABILIDAD
VOLUMEN “ACREDITACIÓN: V-12”
MR-CV-5.6-19.9


Calibración de recipientes volumétricos
método de medida gravimétrico



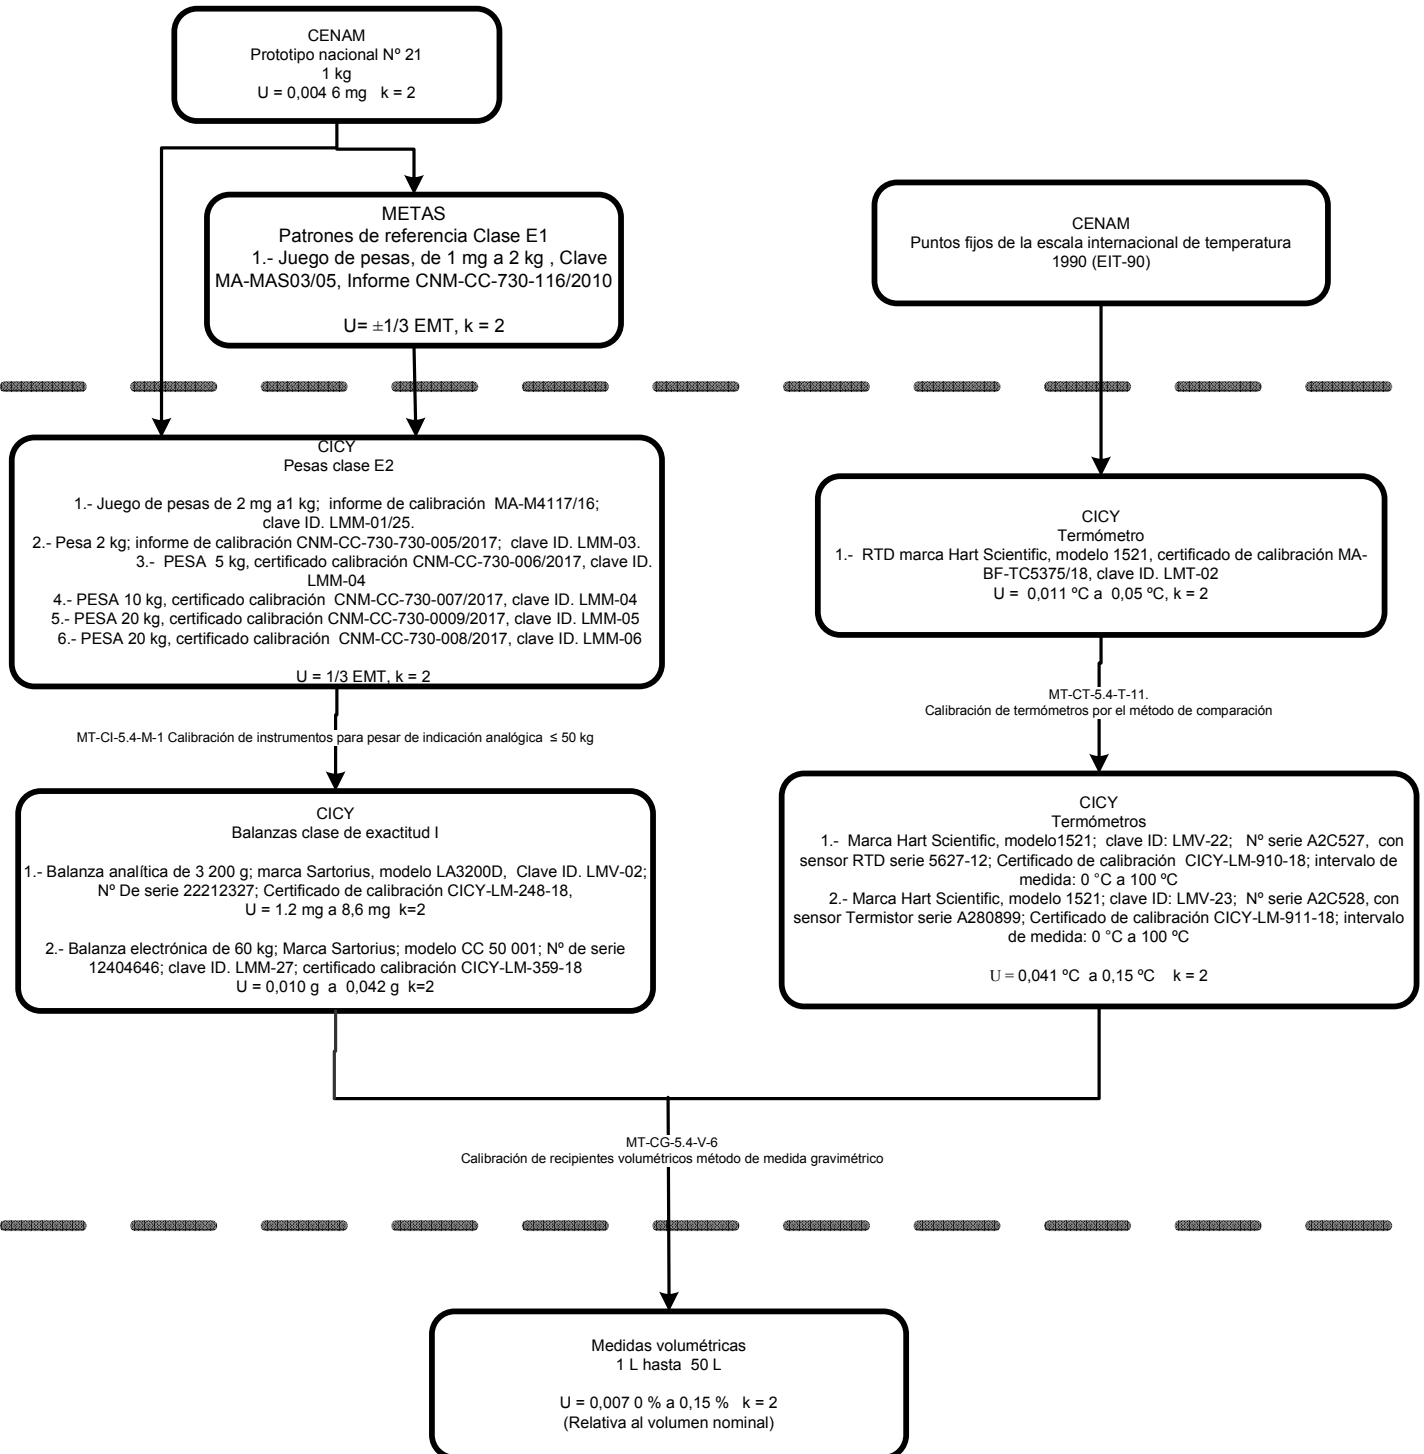

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.
LABORATORIO DE METROLOGÍA
CARTA DE TRAZABILIDAD
VOLUMEN "ACREDITACIÓN: V-12"
MR-CV-5.6-19.9

Calibración de recipientes volumétricos
método de medida volumétrico
-Patrones Volumex-

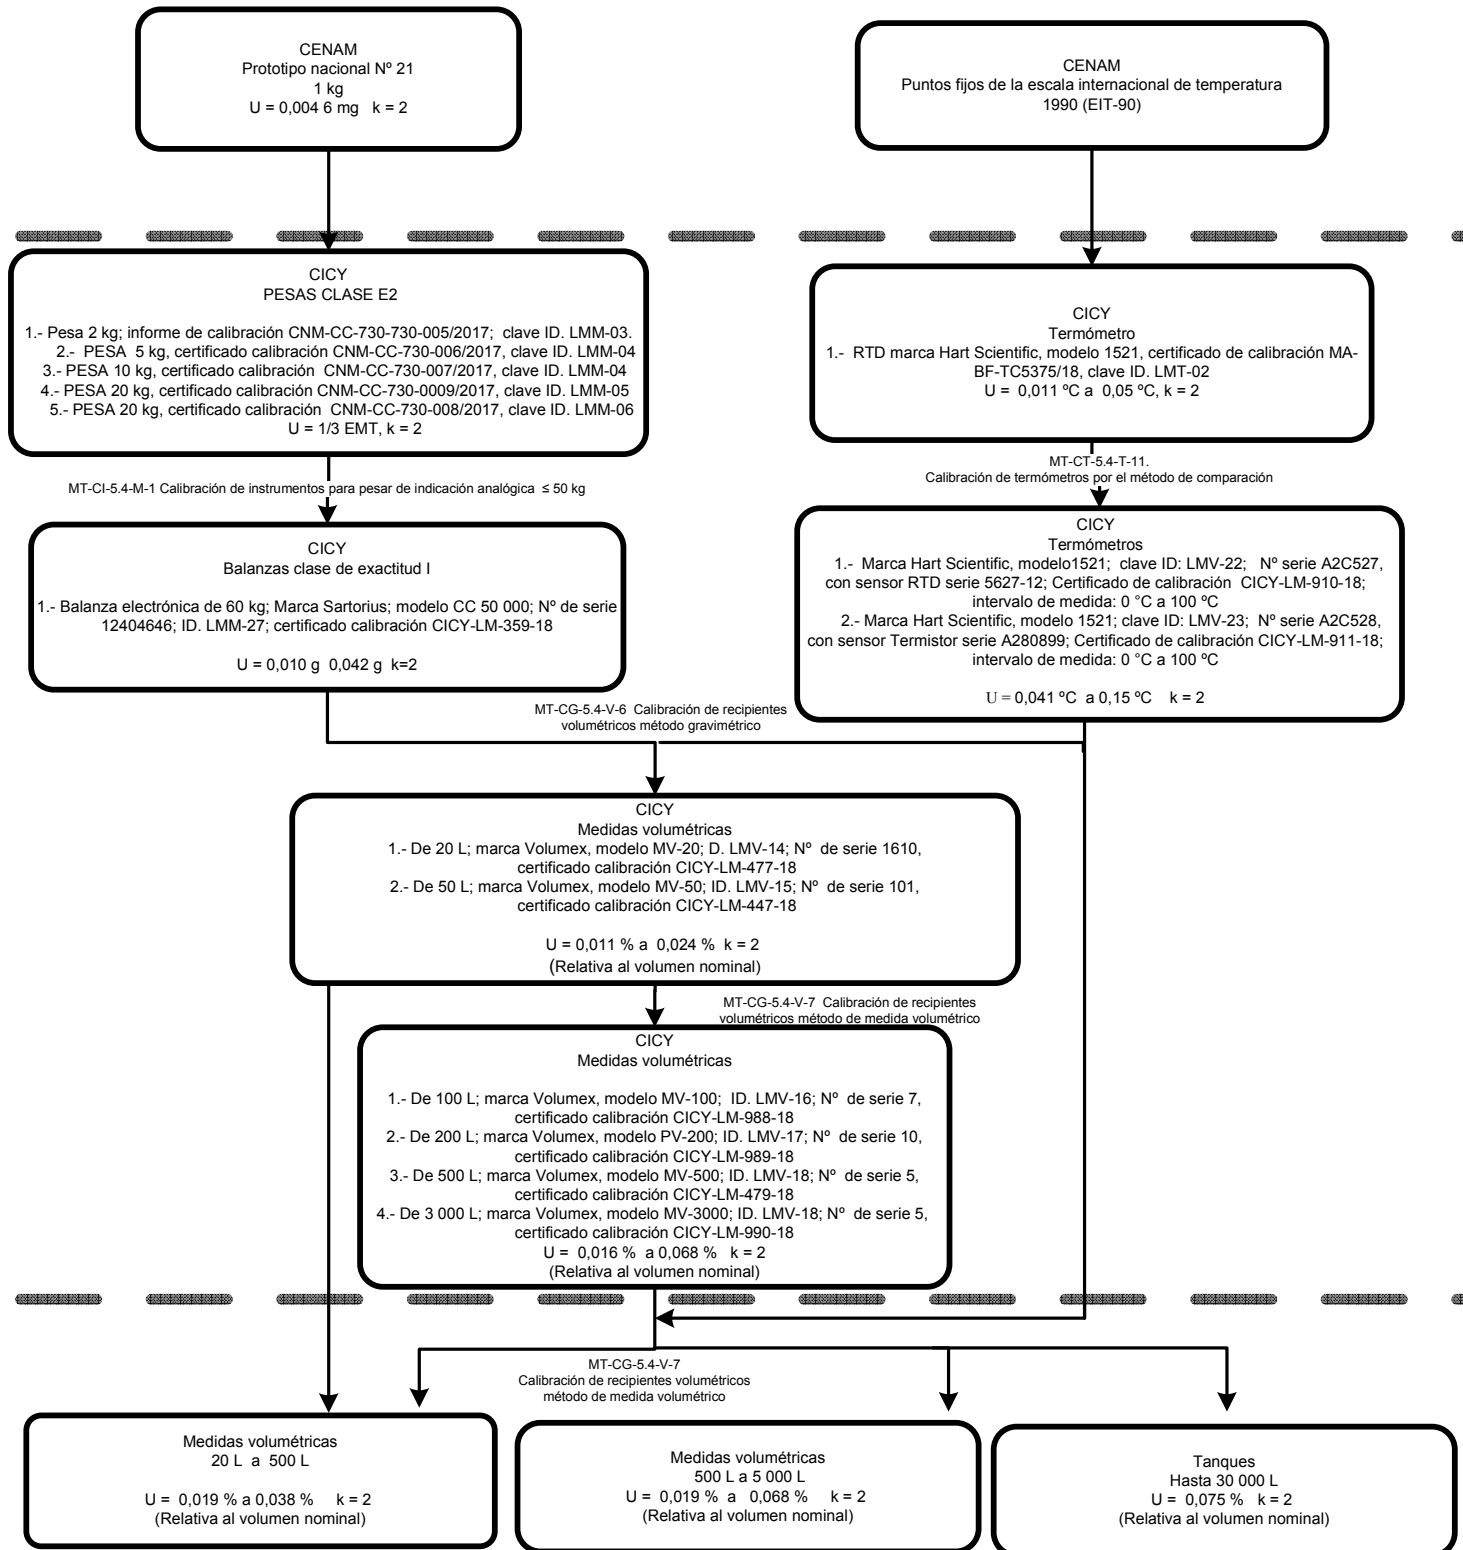



CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.
LABORATORIO DE METROLOGÍA
CARTA DE TRAZABILIDAD
VOLUMEN “ACREDITACIÓN: V-12”
MR-CV-5.6-19.9

Calibración de recipientes volumétricos
método de medida volumétrico
-Patrones Seraphin-

