

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.**  
**LABORATORIO DE METROLOGÍA**  
**CARTA DE TRAZABILIDAD**  
**“TEMPERATURA”**  
**ACREDITACIÓN: T-62**  
**MR-CT-5.6-19.9**  
MÉTODO DE COMPARACIÓN INTERNA  
MT-CT-5.4-T-11



PUNTOS FIJOS  
420AC-P.029  
CENAM


**CENAM**  
PUNTOS FIJOS DE LA ESCALA INTERNACIONAL DE  
TEMPERATURA 1990 (EIT-90)

METAS  
**TERMÓMETRO SPRT**  
MARCA/ MODELO: pt 25,5  
CLAVE ID: MA-RTD33/13;MA-RTD36/14;  
CERTIFICADO: CNM-CC-420-107-2017/CNM-CC-420-113-2018  
INCERTIDUMBRE: (±0,0077 °C ...±0,59 °C)  
K=2

METAS  
**Termopar S**  
CLAVE ID: MA-TCS05/03  
CERTIFICADO: CNM-CC-420-088/2016  
INCERTIDUMBRE: (±0,031 °C ...±2.1 °C)  
K=2

TRAZABILIDAD EXTERNA

TRAZABILIDAD INTERNA

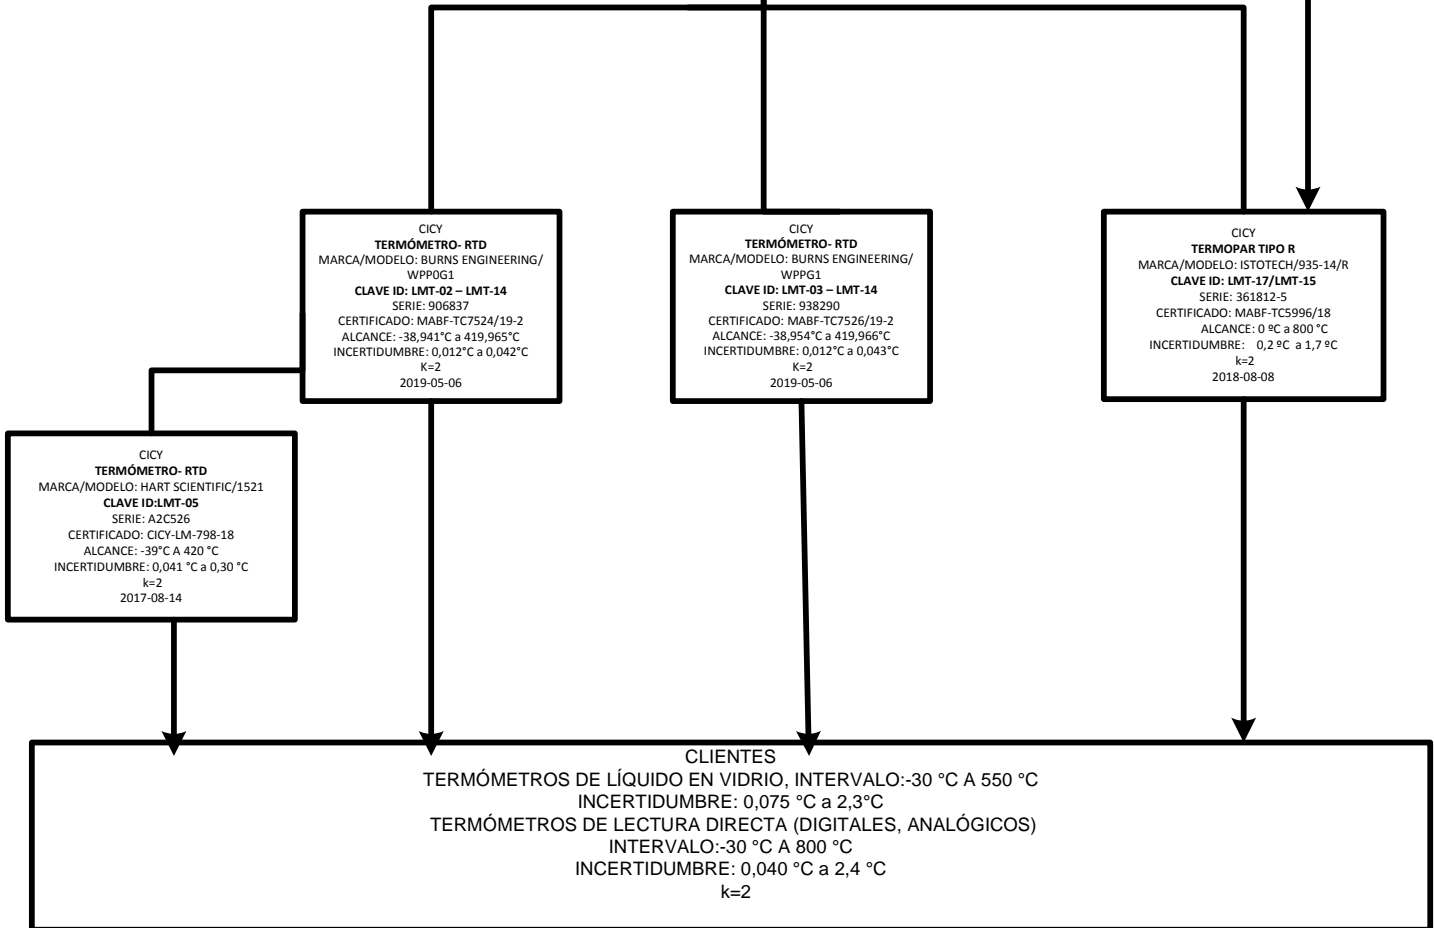

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07 de junio del 2019