

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.**  
**LABORATORIO DE METROLOGÍA**  
**CARTA DE TRAZABILIDAD**  
**“TEMPERATURA”**  
**ACREDITACIÓN: T-62**  
**MF-TC-6.5-10.6**  
MÉTODO DE COMPARACIÓN INTERNA  
MT-CT-5.4-T-11



PUNTOS FIJOS  
420AC-P.029  
CENAM


**CENAM**  
PUNTOS FIJOS DE LA ESCALA INTERNACIONAL DE  
TEMPERATURA 1990 (EIT-90)

METAS  
TERMÓMETRO SPRT  
MARCA/ MODELO: pt 25,5 Ω  
CLAVE ID: MA-RTD33/13;MA-RTD36/14;MA-RTD54/20;MA-TCS05/03  
CERTIFICADO:CNM-CC-420-125/2019/CNM-CC-420-113-2018/C0551070/  
CNM-CC-420-123-2018  
INCERTIDUMBRE: (±0,0077 °C ...±0,59 °C)  
K=2

METAS  
Punto de fusión de hielo/SPRT Pt  
CLAVE ID: MA-PFH06;MA-RTD33/13;MA-RTD36/14; MA-RTD54/20  
CERTIFICADO:ASTM E-563/ CNM-CC-420-125/2019/CNM-CC-420-113/2018/  
C0221070  
INCERTIDUMBRE: (±0,002 °C ± 0,89 °C)  
K=2

TRAZABILIDAD EXTERNA

TRAZABILIDAD INTERNA

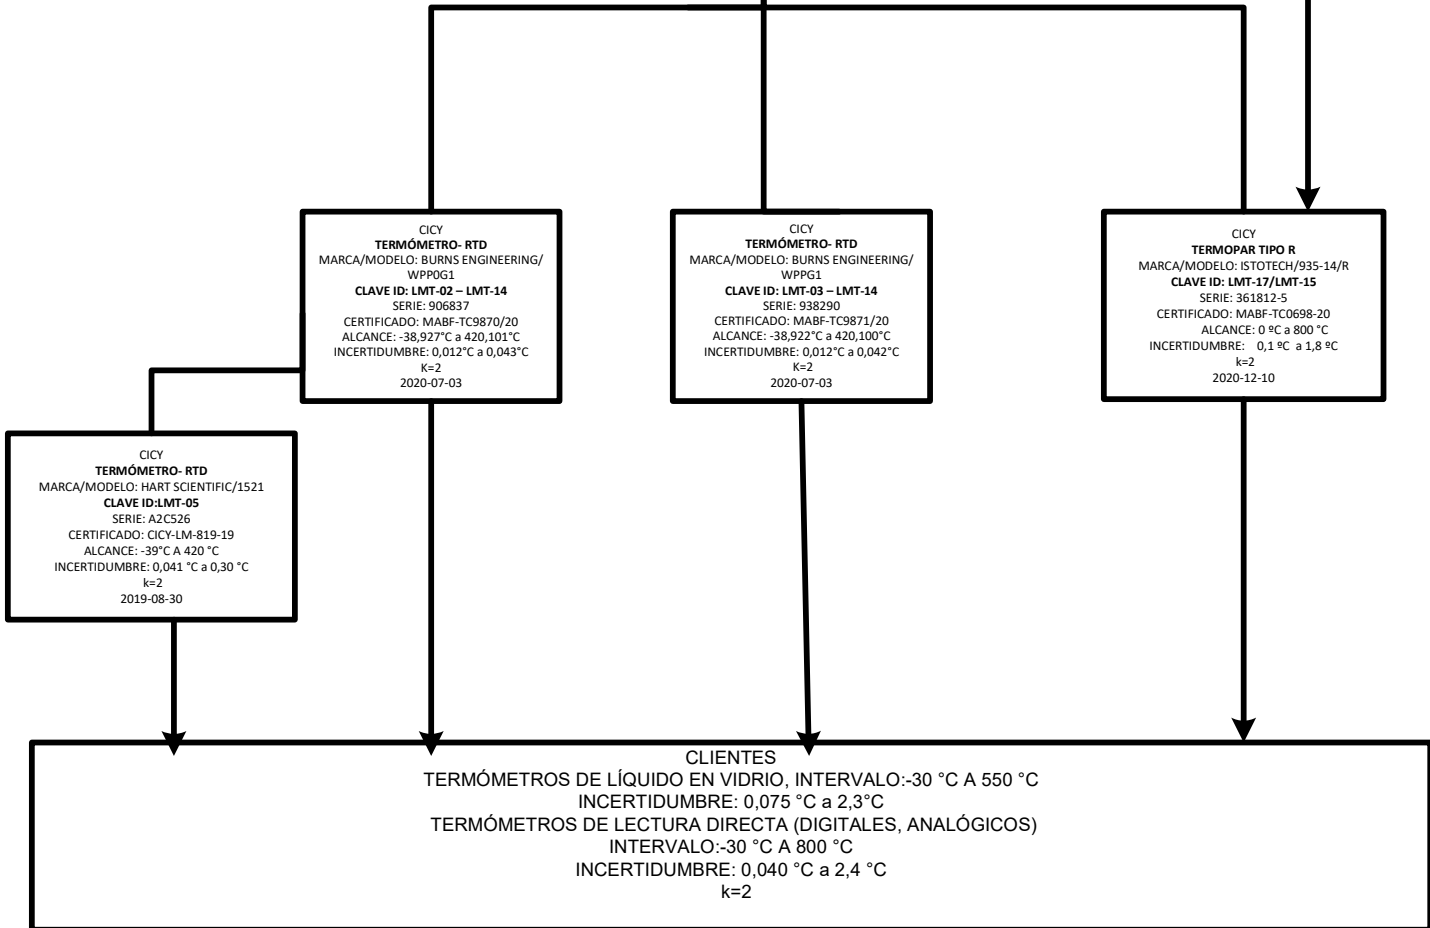

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02 de marzo del 2021