CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN A.C.
LABORATORIO DE METROLOGÍA
CARTA DE TRAZABILIDAD
VOLUMEN "ACREDITACIÓN: V-12"
MF-TC-6.5-10.6
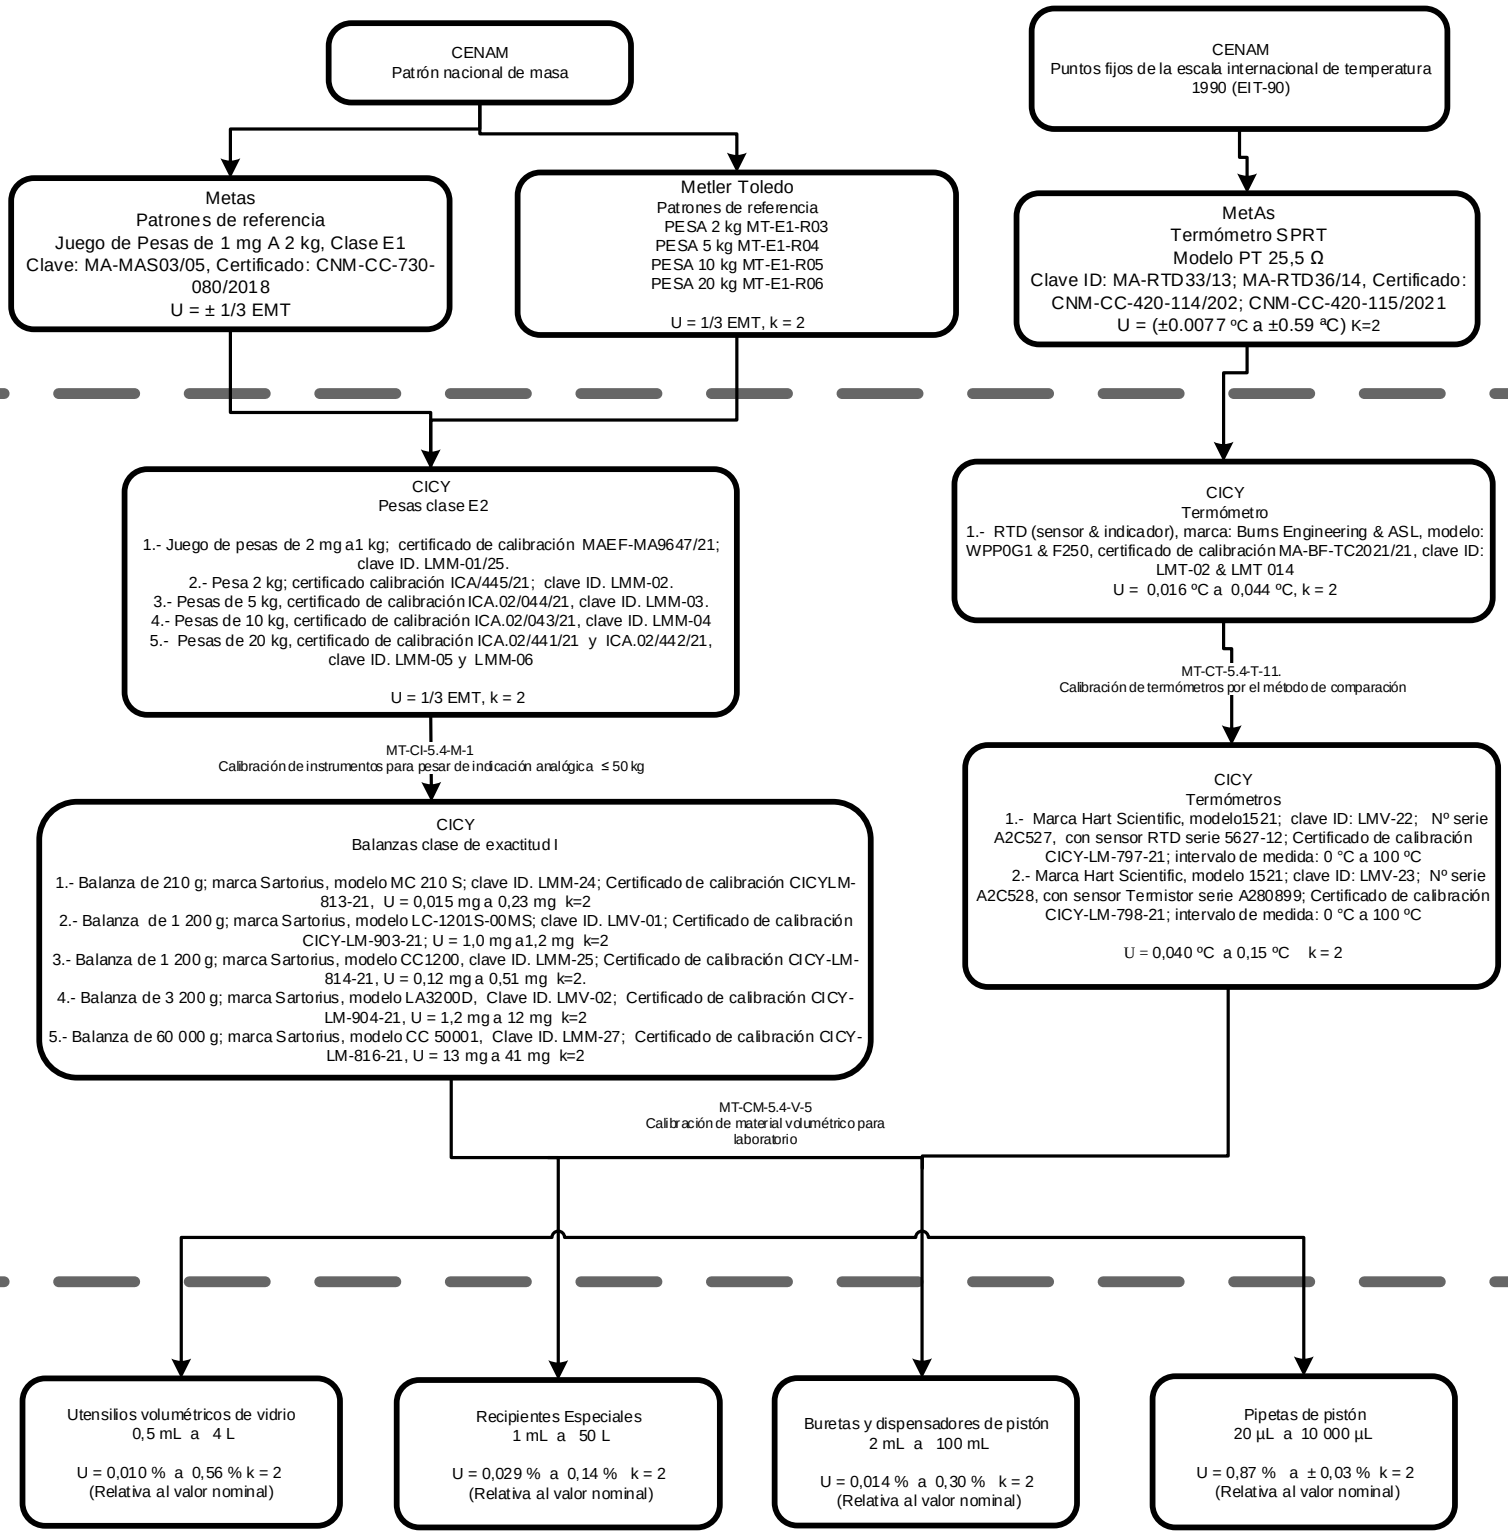
Calibración de material de vidrio y pipetas de pistón
método de medida gravimétrico